


Imię i nazwisko: **Jan Kowalski**
PESEL: **80010111000**
Adres: **Kosynierska 10a/L2**
60-241 Poznań

Data badania: **2026-06-23**
Rodzaj badania: **wodorowy test**
oddechowy po
obciążeniu laktozą

Raport z badania nietolerancji laktozy - 120 min

Test oddechowy wodorowy (H₂) z laktozą (25g)

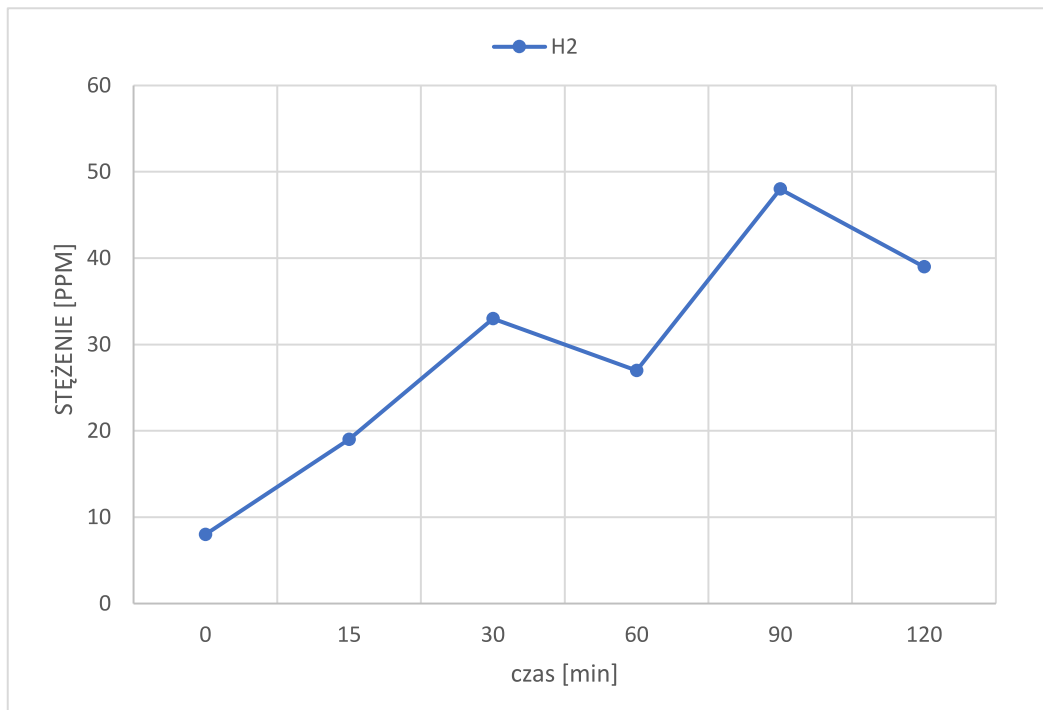

Stężenie wodoru (H ₂) w badanej próbce oddechowej						
Czas [min]	0	15	30	60	90	120
H ₂	8	19	33	27	48	39
CO ₂ *	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Godziny pobrania próbek						
Godzina	08:30	08:45	09:00	09:30	10:00	10:30

*Próbki są korygowane w zależności od stężenia dwutlenku węgla (CO₂) w celu uwzględnienia ich różnic. Nieprawidłowe są klasyfikowane jako niewystarczające.

Podsumowanie wyników		
Wodór (H ₂)	Wartość odczytana	Wartość prawidłowa
Stężenie początkowe H ₂	8 ppm	< 10 ppm
Zmiana stężeń H ₂	40 ppm	< 20 ppm

uwagi:

Badanie wykonano na urządzeniu QuinTron BreathTrackerS.C.


Komentarz

Diagnosis: redness of skin; spots of red or yellow; swelling, tingling, stinging; itching; worse with heat and cold; worse with exercise

W przypadku pojawienia się nowych przebiegów, choroby podległyby reklasacji, zmiany, a także możliwości wyłączenia z programu badawczego w późnym czasie (2005). Drugim ważnym skutkiem takiej klasyfikacji. Tworzy był interpretowanie przez specjalistę, oraz z uwzględnieniem innych dolegliwości oraz doświadczeń badań. W niektórych przypadkach wyłączenie niektórych osób z programu, dlatego warto pamiętać, że niektóre mogą wystąpić w ostatniej godzinie życia.

Przebieg choroby układu (K) z minimum 20 gpn przez 120^{ty} minut w skrajnie do pierwszego poziomu (przez podaniem 1000g) wskazuje na nieistotny wpływ (wyk. prosty). Wskaz wartości układu K w skrajnie 10-20 gpn skrajnie na jęz. granicę dolnej.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

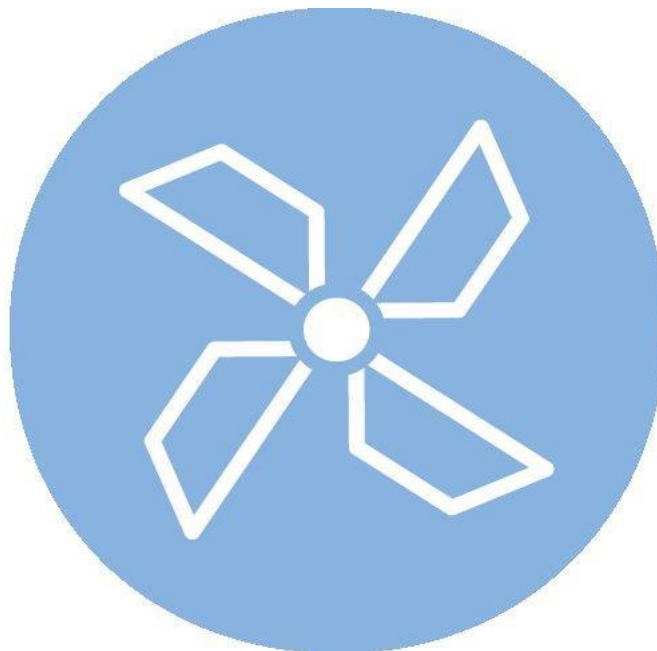

UWAGA: Wyniki badań laboratoryjnych wydawane w formie elektronicznej podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co oznacza, że stanowią pełnoprawne wyniki badań.