


Imię i nazwisko: **Jan Kowalski**
PESEL: **80010111000**
Adres: **Kosynierska 10a/L2**
60-241 Poznań

Data badania: **2026-06-23**
Rodzaj badania: **wodorowy test**
oddechowy po
obciążeniu sorbitolem

Raport z badania nietolerancji sorbitolu - 120 min

Test oddechowy wodorowy (H₂) z sorbitolem (12,5g)

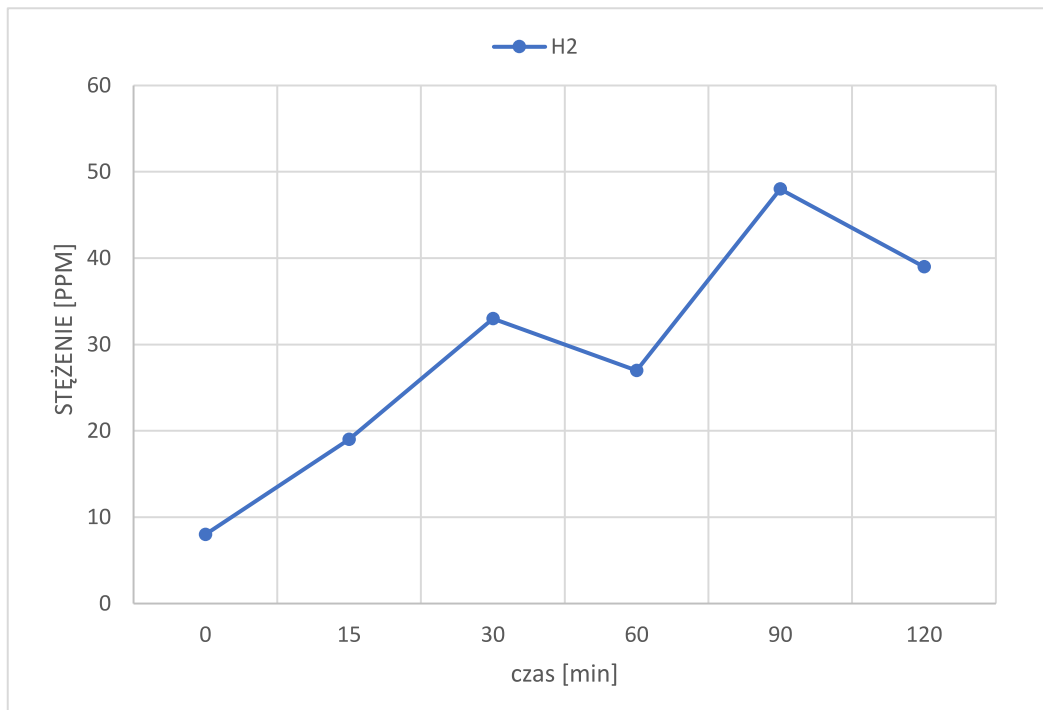

Stężenie wodoru (H₂) w badanej próbce oddechowej

Czas [min]	0	15	30	60	90	120
H ₂	8	19	33	27	48	39
CO ₂ *	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Godziny pobrania próbek						
Godzina	08:30	08:45	09:00	09:30	10:00	10:30

*Próbki są korygowane w zależności od stężenia dwutlenku węgla (CO₂) w celu uwzględnienia ich różnic. Nieprawidłowe są klasyfikowane jako niewystarczające.

Podsumowanie wyników

Wodór (H ₂)	Wartość odczytana	Wartość prawidłowa
Stężenie początkowe H ₂	8 ppm	< 10 ppm
Zmiana stężeń H ₂	40 ppm	< 20 ppm

uwagi:

Badanie wykonano na urządzeniu QuinTron BreathTrackerS.C.


Komentarz

Keywords: *self-esteem, self-esteem threat, self-esteem threat effects, self-esteem threat effects on self-esteem, self-esteem threat effects on self-esteem, self-esteem threat effects on self-esteem*

W przypadku pojawienia się wyroku prezydenckiego, którego podległościom (militarnej) uchylił, a także możliwości wyłączenia go z urzędu (zgodnie z art. 100 Konstytucji). Zgodnie z tymi przepisami, Prezydent ma prawo do amnestii i łaski, a także do wyłączenia z urzędu (zgodnie z art. 100 Konstytucji) i do wyłączenia z urzędu (zgodnie z art. 100 Konstytucji) i do wyłączenia z urzędu (zgodnie z art. 100 Konstytucji).

Wartość stopnia wzdęcia (W) w momencie 20-godz. przez 120^o mierzą w kierunku do przeciwnego półkuli (przeciwnie półkuli wzdęcia) wskazuje na nieobecność wzdęcia (wartość ujemna). Wartość wartości stopnia W w zakresie 10-20 gpn określa się jako granicę normalnej.

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No portion of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from Pearson Education, Inc.

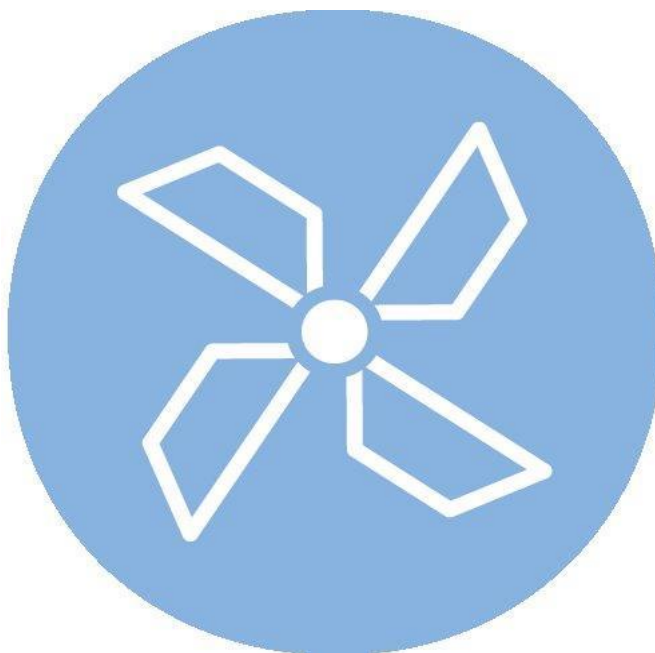

UWAGA: Wyniki badań laboratoryjnych wydawane w formie elektronicznej podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co oznacza, że stanowią pełnoprawne wyniki badań.